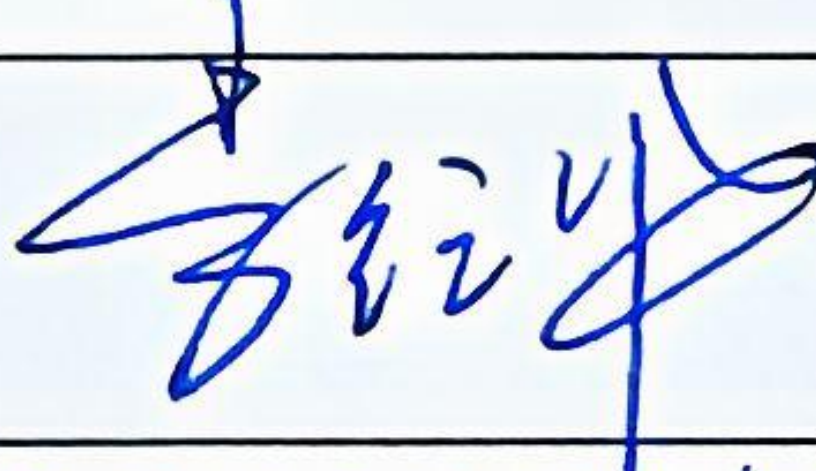
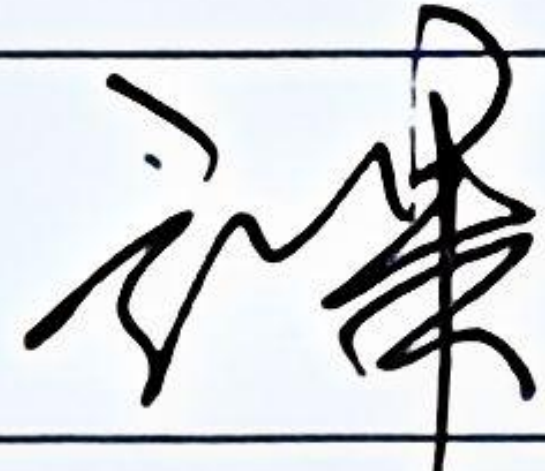
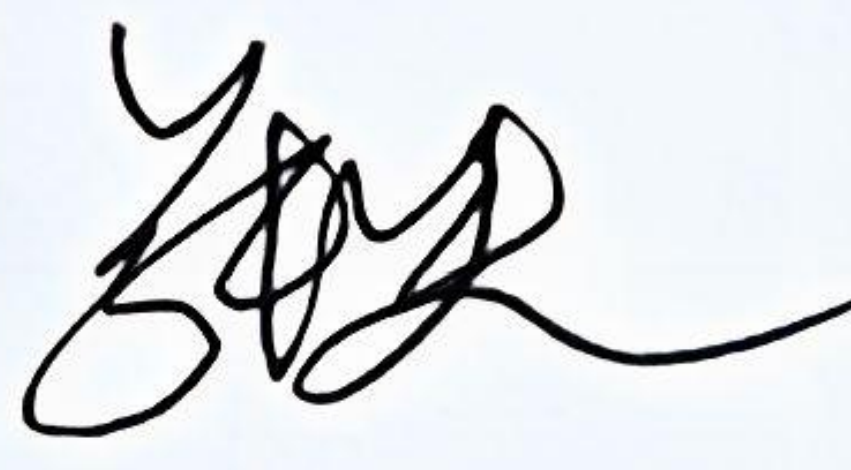


郑州市第一人民医院医疗设备验收报表

采购项目名称	郑州市第一人民医院 2025 年度掺铥光纤激光治疗机采购项目	合同编号	/
设备名称	掺铥光纤激光治疗机	品牌	瑞柯恩
型号	SRM-T1F	数量	1
序列号	RT1F04026005	注册证号	国械注准 20223011612
单价（万元）	142	总价（万元）	142
质保年限	4 年	使用年限	10 年
安放地点	手术室	安装时间	2026 年 4 月 20 日
供货公司名称	河南迅复医疗器械有限公司	公司联系人 工程师/电话	彭南 15638218661
主要配置：掺铥光纤激光治疗机主机 1 台，内窥镜手术刨削器 1 套，脚踏 1 套。			
验收项目	备注	验收项目	备注
到货验收是否合格	是 ☒ /否 ☐	运行是否正常	是 ☒ /否 ☐
生产厂家、供应商资质 是否与投标一致	是 ☒ /否 ☐	合格证（国产） 报关单、商检（进口）	有 ☒ /无 ☐
操作使用培训记录	有 ☒ /无 ☐	技术资料（说明书、 维修手册）	有 ☒ /无 ☐
操作规程	有 ☒ /无 ☐	厂家售后承诺 及维护保养计划	有 ☒ /无 ☐
技术性能是否符合招标技术参数： 是			
验收过程存在问题： 无			
使用科室（签字）		职能科室（签字）	
财务科（签字）	已核验该设备合同内名称、型号、金额，请于 10 个工作日内持票入库。  2026.07.25	监督科室（签字）	

备注：如内容较多，可以附件方式附此表后，附件需项目职能科室签字确认。

验收日期2026 年 7 月 25 日